



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 10.09.2018r.

DZPZ-530-Zp/72/PN-63/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy worków stomijnych, szczypiec bipolarnych, kabli, elektrod neutralnych, kabli, czepków ochronnych dla operatora, drenów do pompy artroskopowej, elektrod Ligasure, igieł do termolezji nadoponowej kręgosłupa, elektrod, optyka laparoskopowa Hopkinsa, retraktora automatycznego laparoskopowego, zestawów do autotransfuzji, siatek do zaopatrywania piersi częściowo wchłaniających, siatek do zaopatrywania piersi pokrytych tytanem - Zp/72/PN-63/18.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2, 3

Pakiet nr 2 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza długość 5m, jeżeli wyrób spełnia pozostałe wymagane parametry SIWZ.

Pakiet nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm², wymiary 176x122mm, pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprrowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, opakowanie 50 szt.?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody z wodoodpornej elastycznej pianki podłoża i wymiarach 128x122mm.

Pakiet nr 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm², wymiary 176x122mm, pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprrowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, opakowanie 50 szt. ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody klejone w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej.

Pakiet nr 3 pozycja 3


Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, hydrożelową, dzieloną o powierzchni 37 cm², wymiarach 181x 76mm, dla noworodków do 5 kg, opakowanie 50 szt.?



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

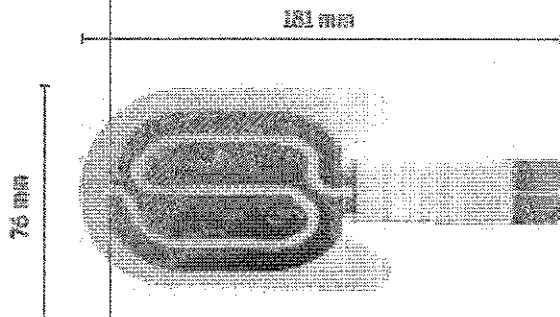

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody o powierzchni 40cm² i wymiarach 110x76mm.

Pakiet nr 3 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza długość 5m, jeżeli wyrób spełnia pozostałe wymagane parametry SIWZ.

Pakiet nr 3 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza długość 5m, jeżeli wyrób spełnia pozostałe wymagane parametry SIWZ.

Pytanie 2. dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści dreny do pompy jednorolkowej jednorazowego użytku, pakowane sterylne wraz z użyczeniem pompy na czas trwania umowy?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dren doprowadzający do pompy Stryker.

Pytanie 3. dot. pakietu nr 3

Pakiet nr 3 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dwudzielną o równych połówkach, przeznaczoną dla dorosłych oraz dla dzieci o wadze od 2kg wraz z dodatkowy pierścieniem ekwipotencjalnym odizolowanym mechanicznie i elektrycznie o łącznej powierzchni 108cm²? Elektroda neutralna zapewnia oprócz równomiernego rozkładu prądu na ciele pacjenta (tak jak w wymaganiach elektroda firmy Bowa) również równomierny rozkład gęstości prądu co zapewnia lepsze zabezpieczenie przed oparzeniem pacjenta.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody dla dorosłych oraz dla dzieci o wadze powyżej 5kg oraz w poz. 1 powierzchni 90cm² i wymiary 128x122mm, w poz. 2 powierzchni 110cm² i wymiary 122x174mm.

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę dwudzielną neutralną o powierzchni 33cm² ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody o powierzchni 40cm².



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalisokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Pakiet nr 3 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli wyrób spełnia pozostałe wymagane parametry SIWZ.

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dwudzielną o powierzchni 110 cm² i wymiarach 122 x 176mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Ekonomicznych
mgr inż. Andrzej Stajzka