



Wałbrzych, dnia 12.02.2020r.

DZPZ-530-Zp/7/PN-7/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: Igły i zestawy zewnątrzoponowe, igły do bezpiecznego rozpuszczania leków, przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, zestaw jednorazowego użytku do znieczulenia rdzeniowego, kasety do Fluido, strzykawka bursztynowa, papier do drukarki Niccomo, elektroda ICG, zestaw do zmiany opatrunku, igły do biopsji szpiku i do trepanobiopsji, elektroda zewnętrzna do czasowej stymulacji serca” - Zp/7/PN-7/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 niżej opisanego zestawu?

- Kleszczyki plastikowe niebieskie – 1szt
- Kompresy włókninowe 5x5cm 4w, 30g – 5szt
- Tupfer gazowy 20/20cm (średnica 35mm) – 5szt
- Strzykawka dwuczęściowa Luer 5ml – 1szt
- Igła 0,8x40mm zielona 21G – 1szt
- Serweta epiduralna dwuwarstwowa 75x80cm z otworem przyklepnym 6x15cm-1szt
- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Wyrób medyczny jednorazowy, zestaw sterylny, pakowany indywidualnie, sterylizowany tlenkiem etylenu. Na opakowaniu brak etykiet przyklepanych do dokumentacji medycznej

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Brak serwety z przyklepcem wzdłuż jednego z brzegów oraz pojemnika na płyny.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawki trzyczęściowej 50 ml bursztynowej w pełni kompatybilnej z pompami infuzyjnymi, nie wpisanej w instrukcję do pomp Kwapisz oraz Ascor?. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia parametry i jest kompatybilna z posiadanymi pompami.


Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym na szczycie który ogranicza pienie się leku, swobodne rozpuszczanie leków poprzez skierowanie płynu na ścianki boczne ampułki-fiolki typu szlif ołówkowy który zapewnia niska siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału w rozmiarze 18G 1,2x40mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w tym rozmiarze.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie igieł w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?



Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie igieł w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SIWZ.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i aspirowania roztworów z wbudowanym filtrem bakteryjnym 1,2um zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga filtra min. 0,1 um

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i aspirowania roztworów z filtrem cząsteczkowym 5um połączony z filtrem bakteryjnym 1,2um?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i aspirowania roztworów w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 25 sztuk?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i aspirowania roztworów w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SIWZ.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 częściowej z dwustronna skala z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadaniem tłoka cylinder i tłok z polipropylenu , cylinder w kolorze bursztynowym z rozszerzeniem 50/60ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie parametry SIWZ.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 częściowej bursztynowej z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadaniem 50ml pakowana po 100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie parametry SIWZ.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy oświadczenie producenta strzykawek będzie odpowiednie do zatwierdzenia kompatybilności strzykawek z pompami infuzyjnymi Duet 20/50 firmy Kwapisz , Ascor?

Odp.: Oświadczenie zostanie przyjęte, zaakceptowane po sprawdzeniu kompatybilności strzykawki z pompą.


Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 igieł do punkcji mostka z plastikowym zakończeniem typu Luer, z regulowaną długością w zakresie 30-50 mm i długością maksymalną 70 mm, z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w poz.3 igły do trepanobiopsji z wewnętrznym mechanizmem wycinającym cylinder kostny i przytrzymującym bioptat, połączonym z igłą tnącą, plastikowym zakończeniem typu Luer, ergonomicznym uchwytem, znakowanym próbnikiem do kontroli długości pobieranego bioptatu, gwintowaną zatyczką do łącznika Luer, dodatkowym przewodnikiem ułatwiającym usunięcie bioptatu w przypadku jego



zablokowania w igle. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 13. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia w następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek samoprzylepny pooperacyjny, 7,2 x 5 cm

Opakowanie:

Tacka min. 100 ml typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Wyposażone w naklejki samoprzylepne identyfikujące zestaw zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuści.

Pytanie 14. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia w następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa (2 x 45 cm x 37,5 cm), regulowana wielkość przylepnego otworu
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml
- 1 x opatrunek samoprzylepny pooperacyjny, 7,2 x 5 cm
- 5 x tupfer z gazy wielkości śliwki

Opakowanie:

Tacka min. 100 ml typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Wyposażone w naklejki samoprzylepne identyfikujące zestaw zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 15. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku w następującym składzie:

- 2 x pęseta
- 6 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Wyposażone w naklejki samoprzylepne identyfikujące zestaw zgodnie z SIWZ.


Odp.: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 16. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku w następującym składzie:

- 5 x kompres z gazy bawełnianej, 5 x 5 cm
- 2 x pęseta plastikowa anatomiczna, 12,5 cm

Opakowanie:



Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Wyposażone w naklejki samoprzylepne identyfikujące zestaw zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 17. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku w następującym składzie:

- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej, 5 x 5 cm
- 5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki *Opakowanie:*

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Wyposażone w naklejki samoprzylepne identyfikujące zestaw zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuści.

Pytanie 18. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – § 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 istotnych postanowień umowy sprzedaży słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 19. Dotyczy Pakietu nr 11

Prosimy o dopuszczenie elektrod endokawitarnych z przewodnikiem J 0.035" o długości 45cm (wymagane 40cm) i rozszerzaczem 6Fr kompatybilnym z koszulką, WSZYSTKIE POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SIWZ;

Odp.: Zamawiający dopuszcza elektrodę endokawitarną z przewodnikiem J 0.035" o długości 45 cm..



Pytanie 20. Dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45° nie powodującym ubytku materiału z korka oraz zapobiegającym zakłuciom w rozmiarze 18G 1,2x25 mm lub 1,2x40mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły z otworem bocznym i szlifem ołówkowym.

Pytanie 21. Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

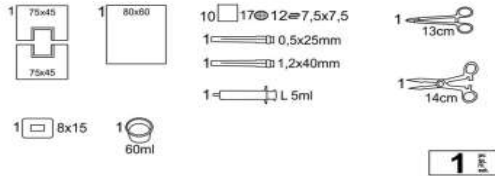

Opis składnika

- IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM)
- IGŁA INIEKCYJNA 25G X 1 (0,5X25MM)
- KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 12W
- SERWETA TF 80X60CM
- SERWETA TF 2X75X45CM REGULOWANY OTWÓR PRZYL
- OPATRUNEK WYSP FIXOPORE F 8X15CM
- STRZYKAWKA PLAST 2CZ 5ML LN TZIEL X
- POJEMNIK PLAST OKRĄG 60ML WYS 3CM ŚR DENKA 5,5CM SKALA TRANSP
- KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM
- KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKI

Ilość Jednostka


Ilość	Jednostka
1,0000	SZ
1,0000	SZ
10,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ

Opakowanie: TPF

Odp.: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 22. Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

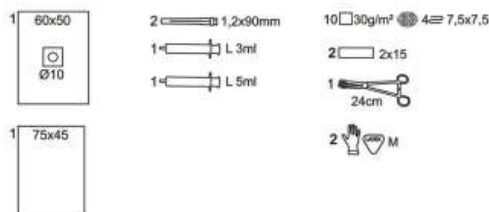

Opis składnika


- RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M WYWINIĘTA
- KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM
- SERWETA L2 60X50CM O10 PRZYL
- SERWETA FB 75X45CM
- IGŁA DO WKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO 18G X 3 1/2 (1,2X90MM) BD
- PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY Z PERFORACJĄ FAŁA 2X15CM POJEDYNCZY
- STRZYKAWKA PLAST 3CZ 5ML LN TTRAN G
- STRZYKAWKA PLAST 3CZ 3ML LC TTRAN G
- KLESZCZYKI PLAST 24CM OKIENKOWE NIEBIESKIE

Ilość Jednostka

Ilość	Jednostka
2,0000	OP
10,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ
2,0000	SZ
2,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ
1,0000	SZ


Opakowanie: TPF

Odp.: Zamawiający nie dopuści.



Pytanie 23. Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

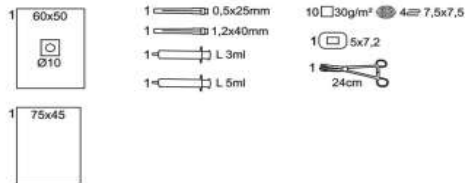

Opis składnika	Ilość	Jednostka
• IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM)	1,0000	SZ
• IGŁA INIEKCYJNA 25G X 1 (0,5X25MM)	1,0000	SZ
• KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM	10,0000	SZ
• SERWETA L2 60X50CM O10 PRZYL	1,0000	SZ
• OPATRUNEK WYSP FIXOPORE EKO 5X7,2CM BEZ OPAKOWANIA	1,0000	SZ
• SERWETA FB 75X45CM	1,0000	SZ
• STRZYKAWKA PLAST 3CZ 5ML LN TTRAN G	1,0000	SZ
• STRZYKAWKA PLAST 3CZ 3ML LC TTRAN G	1,0000	SZ
• KLESZCZYKI PLAST 24CM OKIENKOWE NIEBIESKIE	1,0000	SZ

Opakowanie: TPF

Odp.: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 24. Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi kompresy włókninowe?

Odp.: Zamawiający dopuści jeżeli spełnia pozostałe parametry.

Pytanie 25 Dotyczy projektu umowy

1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? **Odp.:** Terminy podane są w dniach kalendarzowych.
2. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania numeru pakietu na fakturze?
Odp.: Zamawiający nie odstąpi.
4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odp.: Zamawiający zapisał taką możliwość w zał. Nr 3 do SIWZ - § 6 pkt 6
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
6. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?



Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

7. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
8. **Odp.:** w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie **tylko w przypadku każdorazowej ich akceptacji przez Zamawiającego.**

Pytanie 26 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Igły renomowanego producenta 18G, 1,2 x 40 mm, z końcówką o kształcie zbliżonym do skalpela, które przechodzą szybko i łatwo przez korek fiolki. Kształt igły pozwala na szybkie przygotowanie leku przy pomocy igły o większym rozmiarze, bez ryzyka zatkania i wycięcia fragmentów gumy. Zapobiega pienieniu się leków poprzez kierowanie płynu w kierunku ścianki fiolki, sterylne, jednorazowego użytku?

Odp.: **Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły ze szlifem ołówkowym i bocznym otworem.**

Pytanie 27 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej bursztynowej 50ml z rozszerzeniem do 60 ml skalowanej co 1ml na całej długości skali do 60ml, posiadającej zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, strzykawki której przesuw tłoka dokładny i równomierny, z gumowym zakończeniem tłoka, kompatybilnej z pompą Duet 20/50 Kwapisz, Ascor??

Odp.: **Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe parametry i jest kompatybilna z posiadanymi pompami.**

Pytanie 28 :

Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową


Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odp.: **Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odp.: **Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**



Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 1 przyrządu Extra-Spike Plus Chemo, czerwony, posiadającego filtr bakteryjny 0,2µm oraz filtr cząsteczkowy 5µm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-9

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do znieczuleń i punkcji lędźwiowych, o długościach igieł i przewodnic z tolerancją +/- 2mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 1 poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły Pencil-Point z przewodnicą, powinny posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w przewodnice skracają długość roboczą igły podpajęcej o mniej niż 12mm, co umożliwi ich wygodne użycie u pacjentów otyłych, zwiększając tym samym terapeutyczne i diagnostyczne możliwości ich wykorzystania

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 1 poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły Pencil-Point z przewodnicą w najmniejszej ze średnic igieł, będących przedmiotem zamówienia w całym pakiecie, ze względu na precyzję ich użytkowania, powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 1 poz. 13


Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana strzykawka niskooporowa 10ml, powinna posiadać zakończenie luer-lock, w pełni kompatybilne z zakończeniami oferowanych igieł do znieczuleń i punkcji lędźwiowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 4,9

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale muszą posiadać wzór naklejek samoprzylepnych identyfikujących zestaw.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowy do znieczulenia rdzeniowego o minimalnej różnicy w składzie, tj. serweta w rozmiarze 45cm x 45cm z przylepnym otworem o śr. 6 cm?

Odp.: Zamawiający dopuści, jeżeli serweta posiada przylepiec wzdłuż jednego z boków.