

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 22.09.2020r.

DZPZ-530-Zp/46/PN-43/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa: Dren z zastawką Safeflow, Smoczki, Okularki do fototerapii, Elektrody neutralne + pęsety i kable, Igły do termolezji, Worki stomijne, Retraktor automatyczny” - Zp/46/PN-43/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 3


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach;

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

EyeMax 2

*Optimum comfort and protection
during phototherapy treatments.*






EYEMAX 2 INFORMACJE OGÓLNE

▶ EYEMAX 2 OVERVIEW

Our latex-free **EyeMax 2** provides optimum comfort and protection for patients during phototherapy treatments. The one-piece, wraparound design has two attachment points that can be adjusted independently; this prevents unwanted movement and allows for a perfect fit. The ergonomic eye-protection pad was specially designed to prevent ultraviolet light leakage.

PART NUMBERS

Regular (20 pack)R300P01
Preemie (20 pack) R300P02
Micro (20 pack) R300P03

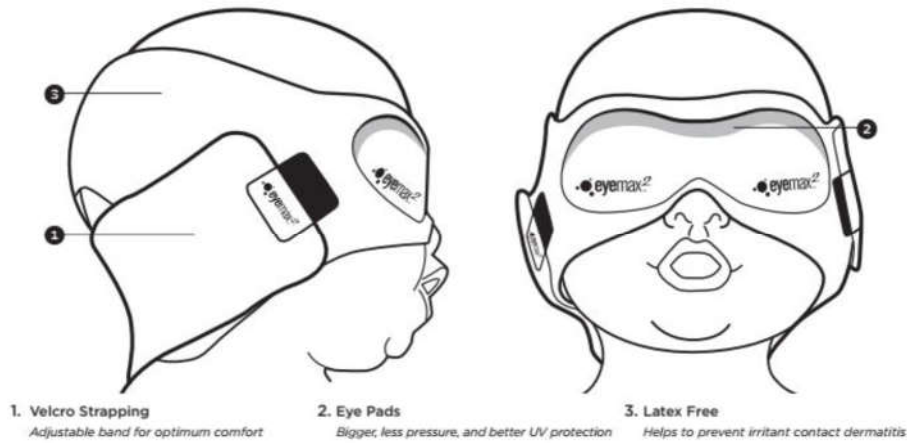

REGULAR (12.6"-14.9")
(Occipital Frontal Circumference)



PREEMIE (10.4"-12.6")
(Occipital Frontal Circumference)



MICRO (7.87"-10.4")
(Occipital Frontal Circumference)


Specifications

Regular	12.6"-14.9" (Occipital Frontal Circumference)
Preemie	10.4"-12.6" (Occipital Frontal Circumference)
Micro	7.87"-10.4" (Occipital Frontal Circumference)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:



Poz.1) Szczypce o dł. 200mm, końcówka 5x1mm i 8x2mm, nieprzywierające, specjalny stop miedzi i srebra, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.2) Szczypce o dł. 200mm, końcówka robocza 5x1mm i 6x2mm, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.3) Szczypce o dł. 200mm, końcówka 5x1mm i 8x2mm, nieprzywierające, specjalny stop miedzi i srebra, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.4,5) Kabel o dł. 5m, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produktu alternatywny, opisany jak niżej:
Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta,

- Wykonane z materiału chroniącego oczy wcześniaków, niemowląt przed szkodliwym promieniowaniem UV, nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne,
- Gwarantujące bezpieczne i trwałe umocowanie na główce dziecka poprzez system wielopunktowego przylegania bezpośrednio do skóry noworodka (zjawisko bioadhezji), bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.
- Materiał miękki, delikatny, bez ostrych brzegów, nie urażający skóry i oczu dziecka, nie ulegający deformacji w czasie stosowania fototerapii
- Wyroby medyczne jednorazowe z możliwością stosowania wielokrotnego u jednego pacjenta, pakowane indywidualnie z oznakowaniem rozmiaru i sugerowanej wagi pacjenta, niesterylne.

Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm (najmniejsze noworodki/ wcześniaki, tj. <28 cm)

Rozmiar 1 110 x 47 mm (noworodki o drobnej budowie główki, tj. 24-34 cm)

Rozmiar 2 130 x 60 mm (wielkość główki – typowa, tj. >30 cm)

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1,2


Ze względu na możliwość zaferowania produktu najwyższej jakości zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwitopotencjalnym, dla dorosłych i dzieci o powierzchni aktywnej 107 cm² i całkowitej 164 x 117 mm – elektroda pokryta hydrożelem, podłoże z pianki z zakończeniem na klips. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pozytywna odpowiedź na pytanie wpłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczną Szpitala.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga powierzchni aktywnej 90 cm² (110 zm²) oraz wymiar 128 x 122 mm (122x174 mm).

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwitopotencjalnym, dla dzieci o powierzchni aktywnej 33 cm² i



całkowitej 88 x 74 mm – elektroda pokryta hydrożelem, podłoże z pianki z zakończeniem na klips. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pozytywna odpowiedź na pytanie wpłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczną Szpitala.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kabla o długości 5 m z możliwością 30-krotnej sterylizacji i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga kabel 4,5 m oraz 300 cykli sterylizacji.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kabla o długości 5 m z możliwością 30-krotnej sterylizacji i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga kabel 4,5 m oraz 300 cykli sterylizacji.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4,5

Prosimy o dopuszczenie kabli o długości 5 m

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga kabel długości 4,5m zakończony klipsem 2,5 cm.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4,5

Prosimy o dopuszczenie kabli z gwarancją na 50 cykli sterylizacji

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga 300 cykli sterylizacji.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularków do fototerapii noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego kawałka materiału.

dostępne w trzech rozmiarach:

Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy,

Wcześnieki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie warunkuje znaczenia renomowanej amerykańskiej firmy i potwierdzenia skuteczności niezależnymi badaniami.


Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarach: Noworodki, 30 – 38 cm, Wcześnieki 24 – 33 cm, Mikro - 20-28 cm, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza okularki w podanych rozmiarach,

Pytanie 12. Dotyczy wzoru umowy.

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC. W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie



praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczanego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odp.

Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez Wykonawcę.

Pytanie 12. Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 13. Dotyczy §6 ust. 6 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 14. Dotyczy §8 ust. 1a wzoru umowy.


Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 15. Dotyczy §9 ust. 3 wzoru umowy.

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.



Pytanie 16.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 6 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 18.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - a) **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.**

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (płytki stomijne pooperacyjne pakowane po 5 szt. w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Wymagamy worek [torba] pooperacyjny sterylny rozmiar otworu 10x70 i 10x100, pojemność 650-750 mm

Pytanie 20.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Wę-grzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury listem poleconym priorytetowym.