



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



Wałbrzych, dnia 10.05.2021r.

DZPZ-530-Zp/12/PN-12/21

## Wykonawcy - wszyscy

**Dotyczy: Dostawa: znacznik do biopsji piersi, zestaw do biopsji wspomaganą próżnią, marker tkanki piersiowej, prowadnica do trudnej intubacji, igły do blokad nerwów, kaniula dożylna z osprzętem, nici okulistyczne, strzykawki, ręczniki z włókniny - Zp/12/PN-12/21.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.


### **Pytanie 1. dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzieleni pozycji nr 1-13 do oddzielnego pakietu, co pozwoli złożyć ofertę większej liczbie wykonawców?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

### **Pytanie 2. dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w poz. 1-7 dopuści: kaniule z 3 szerokimi wtopionymi w cewnik paskami, gwarantującymi dobrą widoczność w promieniach RTG (rysunek poniżej), kaniula w rozmiarze 20 G dostępna w długości 32mm, pozostałe rozmiary i wymagania zgodne z SWZ?

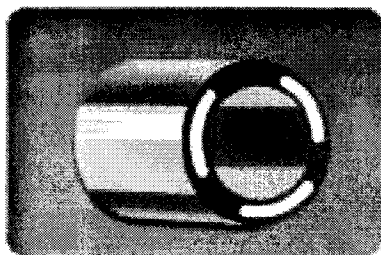


**Odp. Nie Zamawiający nie dopuści, kaniula 20G musi posiadać długość 25mm.**

### **Pytanie 3. dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w poz. 8-13 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły, z 3 szerokimi wtopionymi w cewnik paskami, gwarantującymi dobrą widoczność w promieniach RTG (rysunek poniżej), kaniula w rozmiarze 20 G dostępna w długości 32mm, pozostałe rozmiary i wymagania zgodne z SWZ?



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu

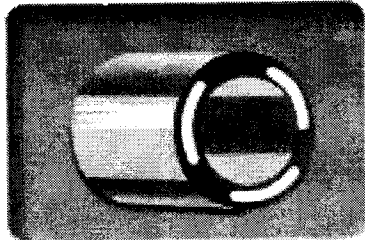

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości kaniul dożylnych włoskiej firmy Delta Med, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych. Na życzenie Zamawiającego możemy wysłać próbki w celu potwierdzenia parametrów oferowanych kaniul.

**Odp. Nie Zamawiający nie dopuści, kaniula 20G musi posiadać długość 25mm.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 5, pozycji nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły do elektrostymulacji:

Igła do blokady nerwów obwodowych rozmiarze 22G/50mm pokryta drobkami szkła, całkowicie echogeniczna (do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami.


**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga: igła do blokady nerwów 22Gx50mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę narożnikowsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjach po 1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, z elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 5, pozycji nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły do elektrostymulacji:

Igła do blokady nerwów obwodowych rozmiarze 21G/85mm pokryta drobkami szkła, całkowicie echogeniczna (do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga: Igła do blokady nerwów 22Gx80mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę narożnikowsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjach po 1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, z elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



#### **Pytanie 6. dot. pakietu nr 5, pozycji nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły do elektrostymulacji:

Igła do blokady nerwów obwodowych rozmiarze 21G/100mm pokryta drobkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga: Igła do blokady nerwów 21Gx100mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę narożnikowsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjach po 1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, z elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock.**

#### **Pytanie 7. dot. pakietu nr 5, pozycji nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły do elektrostymulacji:

Igła do blokady nerwów obwodowych rozmiarze 20G/120mm pokryta drobkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga: Igła do blokady nerwów 20Gx120mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę narożnikowsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjach po 1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, z elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock.**

#### **Pytanie 8. dot. pakietu nr 5, pozycji nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do blokad TAP w rozmiarze 22G/85mm. Igła wysoce echogeniczna aż do czubka igły, piaskowana na całej długości, z odłączalną przedłużką, ścięcie ostrza 30'. Igła znakowana co centymetr

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga igły 22G/80mm.**

#### **Pytanie 9. dot. pakietu nr 5, pozycji nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do blokad TAP w rozmiarze 20G/100mm. Igła wysoce echogeniczna aż do czubka igły, piaskowana na całej długości, z odłączalną przedłużką, ścięcie ostrza 30'. Igła znakowana co centymetr

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga igły 21G/110mm**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



#### **Pytanie 10, dot. pakietu nr 5, pozycji nr 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do blokad w rozmiarze 20G/150mm. Igła pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna (do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga: Igła do blokady TAP 21Gx150mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę narożnikowsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjach po 1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock.**

#### **Pytanie 11, dot. pakietu nr 5, pozycji nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do blokad ciągłych :

Cewnik do stymulacji nerwów obwodowych posiadający właściwości zarówno stymulujące jak i echogeniczne dzięki pokryciu cienką warstwą srebra wzdłuż całej długości cewnika. Długość cewnika :50cm. Stała średnica wewnętrzna:0.4mm. Zewnętrzna średnica: 20G. Opór elektryczny: poniżej 20 om. W skład zestawu wchodzi: igła do stymulacji o długości 85mm i grubości G18, do wyboru przez Zamawiającego ścięta pod kątem 30 stopni, cewnik stymulujący, łącznik easy-lock, filtr antybakteryjny 0,22µ, transparentny opatrunek Dermafilm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga: Zestaw do blokad ciągłych składających się z: igły z końcówką typu Quinke z kablem do stymulacji- w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, z dodatkowym otworem w igle zlokalizowanym między 1 a 2 cm do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli (zewnętrznego cewnika) w technologii „cewnik na igle,, wewnętrzny cewnik z drenem widoczny w USG, mocowany do kaniuli przy pomocy końcówki luer-lock; filtra wraz z systemem mocowania filtra oraz cewnikiem do skóry pacjenta; rozmiar igły 21Gx68 mm; cewnik zewnętrzny 18Gx51 mm.**

#### **Pytanie 12, dot. pakietu nr 5, pozycji nr 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do blokad ciągłych:

Cewnik do stymulacji nerwów obwodowych posiadający właściwości zarówno stymulujące jak i echogeniczne dzięki pokryciu cienką warstwą srebra wzdłuż całej długości cewnika. Długość cewnika :50cm. Stała średnica wewnętrzna:0.4mm. Zewnętrzna średnica: 20G. Opór elektryczny: poniżej 20 om. W skład zestawu wchodzi: igła do stymulacji o długości 100mm i grubości G18, do wyboru przez Zamawiającego ścięta pod kątem 30 stopni, cewnik stymulujący, łącznik easy-lock, filtr antybakteryjny 0,22µ, transparentny opatrunek Dermafilm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga: Zestaw do blokad ciągłych składających się z: igły z końcówką typu Quinke z kablem do stymulacji - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, z dodatkowym otworem w igle**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



zlokalizowanym między 1 a 2 cm do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli (zewnątrznego cewnika) w technologii „cewnik na igle”, wewnętrzny cewnik z drenem widoczny w USG, mocowany do kaniuli przy pomocy końcówki luer-lock; filtra wraz z systemem mocowania filtra oraz cewnikiem do skóry pacjenta; rozmiar igły 21Gx94 mm; cewnik zewnętrzny 18Gx75 mm

**Pytanie 13, dot. pakietu nr 4, pozycji nr 1**

Czy Zamawiający dopuści również długość 70cm?

**Odp. Zamawiający dopuści, ale wymaga również min. 80 cm do wyboru.**

**Pytanie 14, dot. pakietu nr 4, pozycji nr 1**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę pakowaną pojedynczo w ściste opakowanie papierowo-foliowe, a następnie zbiorczo w kartonik po 10 sztuk?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga pojedynczej prowadnicy w sztywnym futerale.**

**Pytanie 15, dot. Projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie 16, dot. Projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) 0,5 % wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.**

b) 10% wartości **brutto** od niezrealizowanej części – w przypadku rozwiązania umowy przez wykonawcę bądź przez zamawiającego z winy wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie 17, dot. Projektu umowy**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy  
**Odp. Zamawiający określił w § 6 ust. 5 i 6 projektu umowy sposoby dostarczania faktur.**

**Pytanie 18, dot. Projektu umowy**

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. §5 ust 3)

**Odp. Ceny podane w umowie są cenami netto i zmiana wysokości stawki VAT w trakcie trwania umowy nie wymaga zmiany umowy.**

**Pytanie 19, dot. pakietu nr 6, poz. 1-16**

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na jednorodną technikę wklucia, oferowane kaniule dożylnie, powinny pochodzić od jednego producenta ?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 20, dot. pakietu nr 6, poz. 1-16**

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na wymóg identyfikacji wyrobu medycznego, oferowane kaniule dożylnie, powinny posiadać min. logo producenta lub inny parametr identyfikujący wyrób medyczny, oznaczone na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 21, dot. pakietu nr 6, poz. 1-13**

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na aseptykę użytkowania, oferowane kaniule dożylnie, powinny posiadać dodatkowy koreczek luer-lock z trzpieniem położonym poniżej własnej krawędzi ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 22, dot. pakietu nr 6, poz. 20-22**

Prosimy o wydzielenie oferowanych kaniul noworodkowych do osobnego pakietu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie 23, dot. pakietu nr 6, poz. 22**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważną kaniulę noworodkową, wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

**Odp. Zamawiający dopuści jeżeli kaniula spełni wszystkie pozostałe parametry określone w SWZ.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. **dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



ISO 9001



---

**Pytanie 24. dot. pakietu nr 5 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do blokad ciągłych spełniający wymogi opisane przez Zamawiającego z igłą w rozmiarze 21Gx101 mm oraz cewnikiem zewnętrznym 18Gx83 mm?

**Odp. Zamawiający dopuści jeżeli zestaw spełni wszystkie pozostałe parametry określone w SWZ.**

**Pytanie 25. dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wymaga przewodnicy wykonanej z poliestrowej plecionki pokrytej medycznym tworzywem?

**Odp. Zamawiający wymaga przewodnicy elastycznej, ale wzmocnionej na całej długości, bez lateksu i ftalanów.**

**Pytanie 26. dot. pakietu nr 5 poz.1**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 pkt.1** dopuści Igłę do blokady nerwów 22Gx50mm, widoczną w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez **wycięcie w igle reflektorów w kształcie X**) na długości **2 cm** do końca igły w trzech sekwencjach z **przerwami ok 2 mm** dla określenia głębokości, z elastycznym **drenikiem** do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 27. dot. pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 pkt. 2** dopuści Igłę do blokady nerwów 22Gx80mm, widoczną w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez **wycięcie w igle reflektorów w kształcie X**) na długości **2 cm** do końca igły w trzech sekwencjach z **przerwami ok 2 mm** dla określenia głębokości, z elastycznym **drenikiem** do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 28. dot. pakietu nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 pkt. 3 dopuści** Igłę do blokady nerwów **20G x100mm**, widoczną w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez **wycięcie w igle reflektorów w kształcie X**) na długości **2 cm** do końca igły w trzech sekwencjach z **przerwami ok 2 mm** dla określenia głębokości, z elastycznym **drenikiem** do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ?.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

#### **Pytanie 29, dot. pakietu nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 pkt. 4** dopuści Iglę do blokady nerwów **20Gx150mm**, widoczną w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez **wycięcie w igle reflektorów w kształcie X**) na długości **2 cm** do końca igły w trzech sekwencjach z **przerwami ok 2 mm** dla określenia głębokości, z elastycznym **drenikiem** do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ?.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły 20Gx120mm.**

#### **Pytanie 30, dot. pakietu nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 pkt. 5** dopuści Iglę do blokady TAP 22Gx80mm, widoczną w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez **wycięcie w igle reflektorów w kształcie X**) na długości **2 cm** do końca igły w trzech sekwencjach z **przerwami ok 2 mm** dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum 20-60 stopni, z elastycznym **drenikiem** do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ?.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 31, dot. pakietu nr 5 poz. 6**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 pkt. 6** dopuści Iglę do blokady TAP 20G x100mm, widoczną w USG przez umieszczenie w igle (powstałych przez **wycięcie w igle reflektorów w kształcie X**) na długości **2 cm** do końca igły w trzech sekwencjach z **przerwami ok 2 mm** dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum 20-60 stopni, z elastycznym **drenikiem** do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ?.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły 21Gx110mm.**

#### **Pytanie 32, dot. pakietu nr 5 poz. 7**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 pkt. 7** dopuści Iglę do blokady TAP 20Gx150mm, widoczną w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez **wycięcie w igle reflektorów w kształcie X**) na długości **2 cm** do końca igły w trzech sekwencjach z **przerwami ok 2 mm** dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum 20-60 stopni, elastycznym **drenikiem** do podania leku zakończonym Luer-Lock.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Opakowanie sterylne, pojedyncze.  
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ?  
**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 33. dot. pakietu nr 5 poz. 8 i 9**

Prosimy o dopuszczenie w **Pakiecie 5 pkt 8 i 9** Tożsamego zestawu do blokad ciągłych składających się z : igły z końcówką typu Quinke z kablem do stymulacji- igły w pełni izolowanej poza czubkiem, o konstrukcji zapewniającej odbicie fal ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, kaniula (zewnątrzny cewnik) w technologii „cewnik na igle”, **cewnik wraz z igłą widoczny w USG**, fabrycznie założony na igle ; filtr wraz z systemem mocowania filtra; **rozmiar igły 25G x190 mm ; cewnik zewnętrzny 19G x 188 mm**, dodatkowy ruchomy uchwyt umożliwiający precyzyjne doprowadzenie cewnika na igle w pobliże nerwu.

Długość igły wraz z cewnikiem daje możliwość tym samym zestawem znieczulić nerwy położone głębiej jak i płycej.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga 2 różnych zestawów.**

**Pytanie 34. dot. pakietu nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej przewodnicy do trudnej intubacji o O.D. : 3,3 i 4,7 długości części roboczej 384mm, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP, w opakowaniu zabezpieczającym typu folia/papier.

**Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga przewodnicy w sztywnym futerale i długości min. 60 i 80 cm.**

**Pytanie 35. dot. pakietu nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych ręczników jednorazowego użytku w rozmiarze 40x40cm, wykonanych z pulpy celulozowej 50% i poliestru 50%, gramatura 54,9g/m<sup>2</sup>, o bardzo wysokiej chłonności, opakowanie typu blister zawiera dwie sztuki ręczników, karton zbiorczy zawiera 450 sztuk.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylnych ręczników jednorazowego użytku wykonanych z pulpy celulozowej.**

**Pytanie 36. dot. pakietu nr 6 poz. 1-7**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1-7 dopuści wycenę kaniul wykonanych z PTFE z filtrem hydrofobowym, z dwoma paskami RTG, z koreczkiem portu bocznego zamykanym standardowo; z koreczkiem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi. Rozmiary odpowiednio: 24Gx19mm, 22Gx25mm, 20Gx32mm, 18Gx45mm, 16Gx45mm, 17Gx45mm, 14Gx45mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga rozmiarów zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 37. dot. pakietu nr 6 poz. 14-16**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 14-16 dopuści wycenę kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego wykonanej z poliuretanu, z zastawką oraz trzema paskami RTG. Rozmiary 16Gx45mm, 18Gx45mm, 14Gx45mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga rozmiarów zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 38, dot. pakietu nr 6 poz. 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 17 dopuści wycenę kranika o wytrzymałości ciśnieniowej do 3 Bar?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga wysokiej wytrzymałości kranika, do 5-6 barów.**

**Pytanie 39, dot. pakietu nr 6 poz. 18**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 18 dopuści wycenę opakowania x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie 40, dot. pakietu nr 6 poz. 19**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 19 dopuści wycenę kranika z przedłużką o wytrzymałości ciśnieniowej do 0,5 Bar?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga wytrzymałości do 3 barów.**

**Pytanie 41, dot. pakietu nr 6 poz. 22**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 22 dopuści wycenę kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP, z dwoma paskami RTG, z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego; z koreczkiem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi. Rozmiar 26G 0,62x19mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga kaniuli, rozmiar 24G.**

**Pytanie 42, dot. pakietu nr 6 poz. 22**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 22 dopuści wycenę kaniuli bezpiecznej wykonanej z poliuretanu, z sześcioma paskami RTG, z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego; z koreczkiem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi. Rozmiar 24G 0,7x19mm?

**Odp. Zamawiający dopuści, jeśli kaniula spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie 43, dot. pakietu nr 9 poz. 1-4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 1-4 dopuści wycenę opakowania x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie 44, dot. pakietu nr 9 poz. 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 9 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 0,5ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga strzykawki skalowanej co 0,2 ml.**

**Pytanie 45, dot. pakietu nr 9 poz. 7-14**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 7-14 dopuści wycenę opakowania x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie 46, dot. pakietu nr 9 poz. 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 12 dopuści wycenę strzykawki z wbudowaną igłą w rozmiarze 0,3x12,7mm?

**Odp. Zamawiający dopuści, jeśli strzykawka spełni pozostałe parametry określone w SWZ.**

**Pytanie 47, dot. pakietu nr 9 poz. 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 12 dopuści wycenę strzykawki z igłą dokładaną w opakowaniu?

**Odp. Zamawiający nie dopuści.**

Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700

DYREKTOR SZPITALA

*Mariola Dudziak*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742

